



Der Moment gehört Ihnen. Nicht dem Diabetes.

Mit dem **OneTouch Select[®] Plus**
Blutzuckermessgerät



ONETOUCH[®]

Die ColourSure® Technology erleichtert es zu erkennen, wann Sie reagieren müssen*

Wenn Sie die Zeit vergessen, kann es schwierig sein, Ihren Blutzuckerspiegel zu regulieren.


Das **OneTouch Select® Plus** Blutzuckermessgerät mit **ColourSure® Technology** zeigt automatisch an, ob Ihr Blutzuckerspiegel **zu niedrig**, **im Zielbereich** oder **zu hoch** ist, sodass es leichter* ist, zu verstehen, wann Sie reagieren müssen.†



Unter Ihrem Ergebnis erscheint ein Hinweis, der die Messung einordnet und auf die entsprechende Farbe in der Bereichsanzeige unterhalb des Displays verweist.



Zu niedrig



Im Bereich



Zu hoch

Die **Wahrscheinlichkeit**, dass Patienten auf ein mit der **ColourSure® Technology** erhaltenes Blutzuckermessergebnis **reagieren**, war **4x mal höher** als bei einem nicht farbig dargestellten Ergebnis*

ColorSure®
TECHNOLOGY

*Im Vergleich zu einem Ergebnis ohne farbliche Darstellung. Die Daten basieren auf einer bei 103 Diabetikern in den Jahren 2015 und 2016 in Großbritannien durchgeführten Studie, bei der simulierte Blutzuckermessergebnisse mit und ohne farbige Bereichsanzeige (ColourSure® Technology) untersucht wurden. (nicht veröffentlichte Studie)

†Therapieentscheidungen müssen sich nach dem absoluten gemessenen Wert und den ärztlichen Empfehlungen richten.

*Basierend auf einer Simulationsstudie von 2015 zu Blutzuckermessergebnissen mit und ohne einer farbigen Bereichsanzeige, in der 65 % der 94 befragten Insulinpatienten zustimmten. Durchführung der Studie in Großbritannien im Dezember 2015 und Februar 2016. (nicht veröffentlichte Studie)

Personalisieren Sie Ihren Zielbereich

Die Zielbereichsgrenzwerte der Blutzuckermessergebnisse können sich unterscheiden, je nachdem, ob sie vor der Mahlzeit (voreingestellte Grenzwerte 70 – 130 mg/dl) oder nach der Mahlzeit (voreingestellte Grenzwerte 120 – 180 mg/dl) gemessen werden.

Sofern Sie eine Mahlzeitenmarkierung eingefügt haben, wendet das OneTouch Select® Plus Blutzuckermessgerät Ihre individuellen Bereichsgrenzen für die Messung vor oder nach einer Mahlzeit auf Ihr Ergebnis an.*



Genauigkeit, der Sie vertrauen können

Der OneTouch Select® Plus Teststreifen erfasst die natürlichen Schwankungen in Ihrem Blut, sodass Sie sich jederzeit auf Ihre Messergebnisse verlassen können.



*Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem medizinischen Fachpersonal darüber, welche oberen und unteren Bereichsgrenzwerte für Sie richtig sind.

ONETOUCH

Einfaches Testen in nur 2 Schritten


Schritt 1:
Einführen eines
OneTouch Select® Plus
Teststreifens



Schritt 2:
Bluttropfen auf den
Teststreifen geben



Und das wars.
Durch
Benachrichtigungen
und Anweisungen
wissen Sie, wie es um
Ihren Blutzucker steht

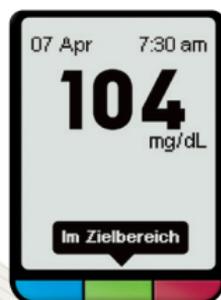

Fragen Sie heute Ihren Arzt
oder Apotheker für weitere
Informationen über das
OneTouch Select® Plus
Blutzuckermessgerät.



Chatten Sie mit uns:
www.OneTouch.de

Erreichbar: Mo. - Fr. 8:00-17:00 Uhr



kontakt@onetouch.de

Registrieren Sie Ihr OneTouch Select® Plus
- Messgerät noch heute unter
www.OneTouch.de